

[TGシリーズ]

C11482GA



## 近赤外域 (NIR)用、光学系・イメージセンサ・回路を一体化

ミニ分光器 C11482GAは、光学素子とセンサ回路をコンパクトにまとめた分光器 (ポリクロメータ)です。測定光を光ファイバ経由で入光し、分光結果をUSB接続でPCに取り込むことにより、分光スペクトルの収集が可能です。手のひらサイズで、USBバスパワーのみで駆動できます。

本製品には、測定条件の設定、データの取得および保存、グラフの表示などの機能をもつ評価用ソフトウェアを付属されています。また、DLLの関数仕様を公開しているため、ユーザーサイドで独自の計測ソフトウェアを作成することが可能です。

### 特長

- ➔ 石英製透過型グレーティングの採用による高スループット
- ➔ 高精度な光学特性
- ➔ 外部電源不要 (USBバスパワー使用)
- ➔ コンパクト設計により機器への組み込みも可能
- ➔ 波長変換係数\*1を内蔵メモリに記録


### 応用例

- ➔ 水分測定
- ➔ 光通信用部品の評価
- ➔ 膜厚測定

\*1: イメージセンサの画素 No.を波長に変換する係数。A/D変換後のカウント値を入力光量に比例する値に変換する係数は用意していません。

### 光学的特性

項目	仕様	単位
感度波長範囲	900 ~ 1700	nm
波長分解能 (半値幅)*2	Typ.	5
	Max.	7
波長再現性*3	-0.2 ~ +0.2	nm
波長温度依存性	-0.04 ~ +0.04	nm/°C
輝線迷光*2 *4	-33 max.	dB

\*2: 記載の値は「構成」表中のスリット使用時。波長分解能はスリットに依存します。

\*3: 入光条件などが一定の場合

\*4: 波長 1300 nmを入力したときの測定されるカウントと、その波長の±40 nmで測定されるカウントの比

### 電気的特性

項目	仕様	単位
A/D変換	16	ビット
蓄積時間	6 μs ~ 10 s	-
インターフェース	USB 2.0	-
USBバスパワー消費電流	350 max.	mA

## ■ 構成

項目	仕様	単位
外形寸法 (W × D × H)	38.5 × 106 × 86	mm
質量	280	g
イメージセンサ	InGaAsリアイメージセンサ(G9204-512D)	-
画素数*5	512	画素
スリット*6 (H × V)	70 × 500	μm
NA*7	0.22	-
光ファイバ用コネクタ	SMA905D	-

\*5: 不良画素はありません (Lowゲインにおける検査時)。なお不良画素は、イメージセンサの電気的および光学的特性において規定外の画素です。

\*6: 入射開口部の大きさ

\*7: 開口数 (立体角)


## ■ 絶対最大定格

項目	条件	定格値	単位
動作温度	結露なきこと*8	+5 ~ +40	°C
保存温度	結露なきこと*8	-20 ~ +70	°C

\*8: 高温環境においては、製品とその周囲で温度差があると製品表面が結露しやすく、特性や信頼性に影響が及ぶことがあります。


注) 絶対最大定格を一瞬でも超えると、製品の品質を損なう恐れがあります。必ず絶対最大定格の範囲内で使用してください。

## ■ 波長分解能 – 波長 (代表例)

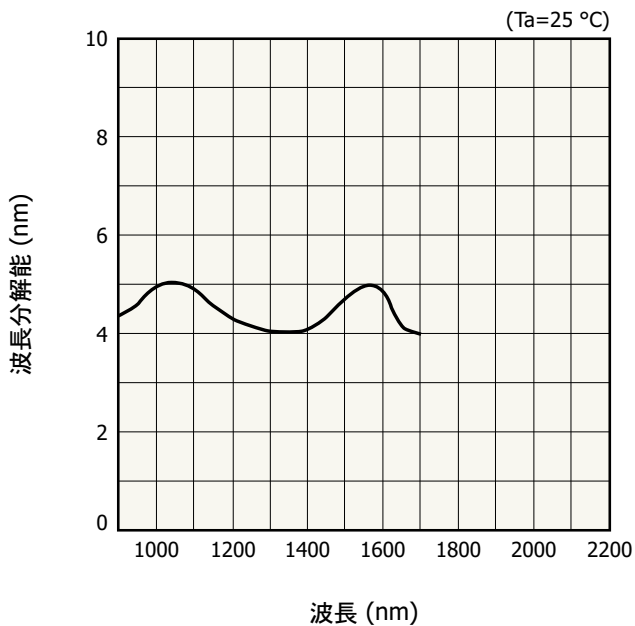

KACCB02623A


## ■ 直線性 (代表例)

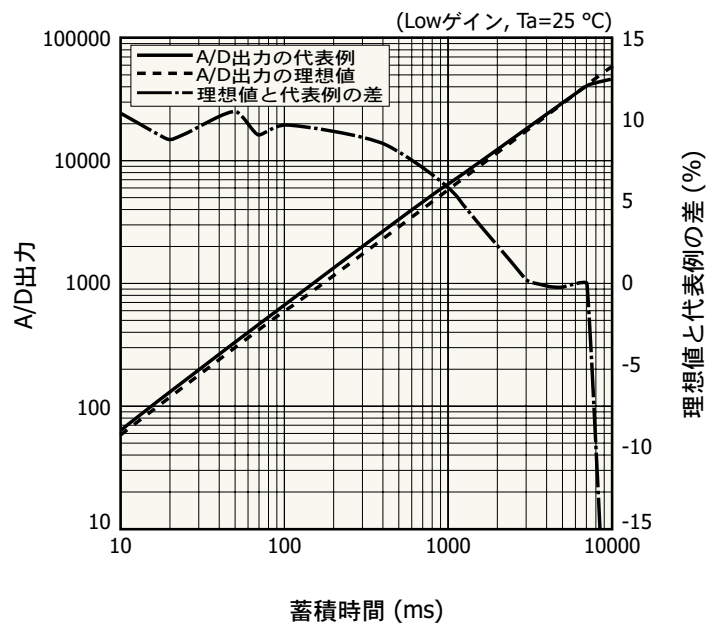

KACCB02503B

A/D出力は、光入射時の出力から暗出力を減算したものです。理想値と代表例の差には、測定誤差が含まれます。A/D出力が小さいときは、測定誤差が大きくなります。

## 暗出力ー周囲温度 (代表例)

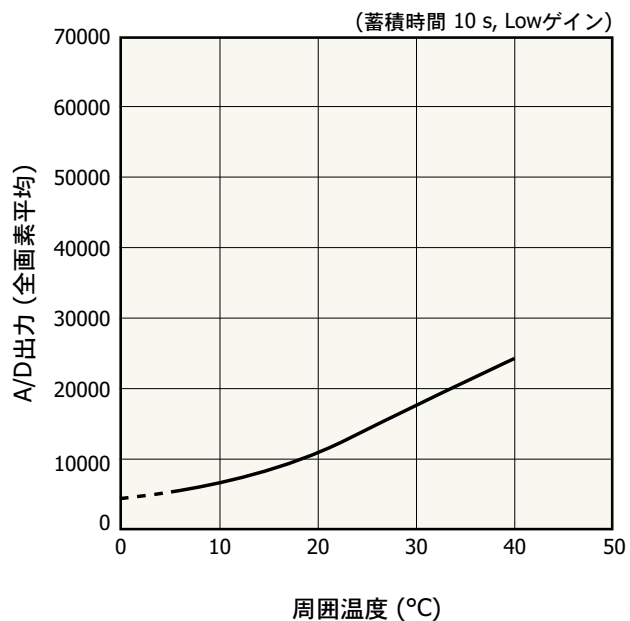


KACCB02531A

A/D出力は、センサおよび回路のオフセット出力とセンサ暗出力が加算されたものです。

## 光学系配置図


ミニ分光器 C11482GAは、石英製の透過型ホログラフィックグレーティングを採用し、光学系を堅牢な光学ベース上に配置することにより、高いスループットと高精度な光学特性を実現しています。

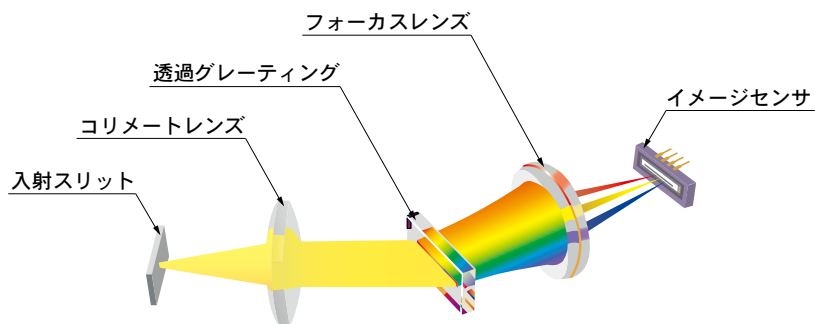

KACCC02561A

## ■ 接続例 (透過光計測)

測定光を光ファイバ経由で入光し、分光結果をUSB接続でPCに取り組むことにより、分光スペクトルの収集ができます。装置内部に可動部分がないため、常に安定した測定が期待できます。また、導光部に光ファイバを用いているため、測定物へのフレキシブルなセッティングが可能です。

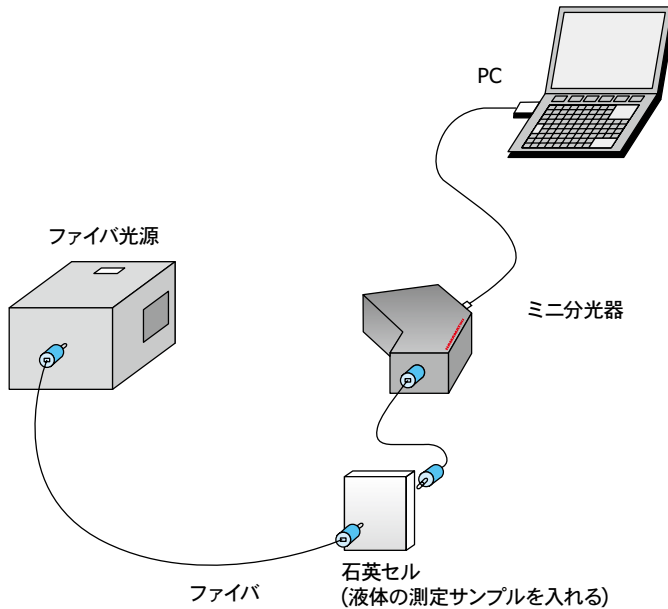


KACCC06891B

## ■ 評価用ソフトウェア (付属品)

評価用ソフトウェア (SpecEvaluationUSB2.exe)\*9をPCにインストールすることにより、以下の基本的な操作を行うことができます。

- ・測定データの取得、保存
- ・測定条件の設定
- ・モジュール情報 (波長変換係数、分光器タイプなど)の取得
- ・グラフ表示
- ・演算機能
  - 画素No.から波長への変換
  - 参照データとの比較演算 (透過率、反射率)
  - ダーク減算
  - ガウス近似 (ピークの位置とカウント、半値幅)

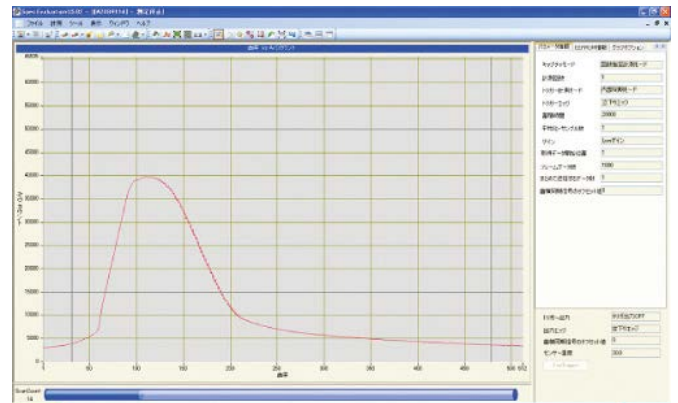

注) 1台のPCに8台までのミニ分光器を接続して使用することも可能です。

\*9: 対応OS: Microsoft Windows 10 Professional (32-bit, 64-bit)

ハードウェアを制御するためのDLLを用意しています。

以下の開発環境を用いて、ユーザーサイドにて独自の測定プログラムを開発することが可能です。

Microsoft Visual Studio® 2008 (SP1) Visual C++®


Microsoft Visual Studio 2008 (SP1) Visual Basic®

注) Microsoft、Windows、Visual Studio、Visual C++、Visual Basicは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

## 測定例

## 膜厚測定 (白色干渉法)

厚さ10 μmの食品用ラップ (ポリ塩化ビニリデン)の膜厚を測定

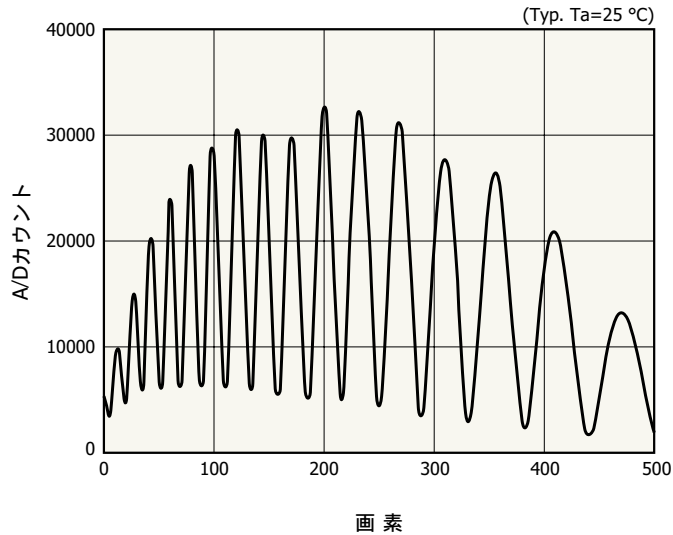


KACCB0095JB

注) 膜厚測定原理:

白色干渉法による膜厚測定の場合、膜の表面と裏面での反射光が互いに干渉し合い波打ったスペクトルが得られます。

スペクトルのピークの数、波長範囲、膜の屈折率、光の入射角より計算して膜厚を求めることができます。

## 外形寸法図 (単位: mm)

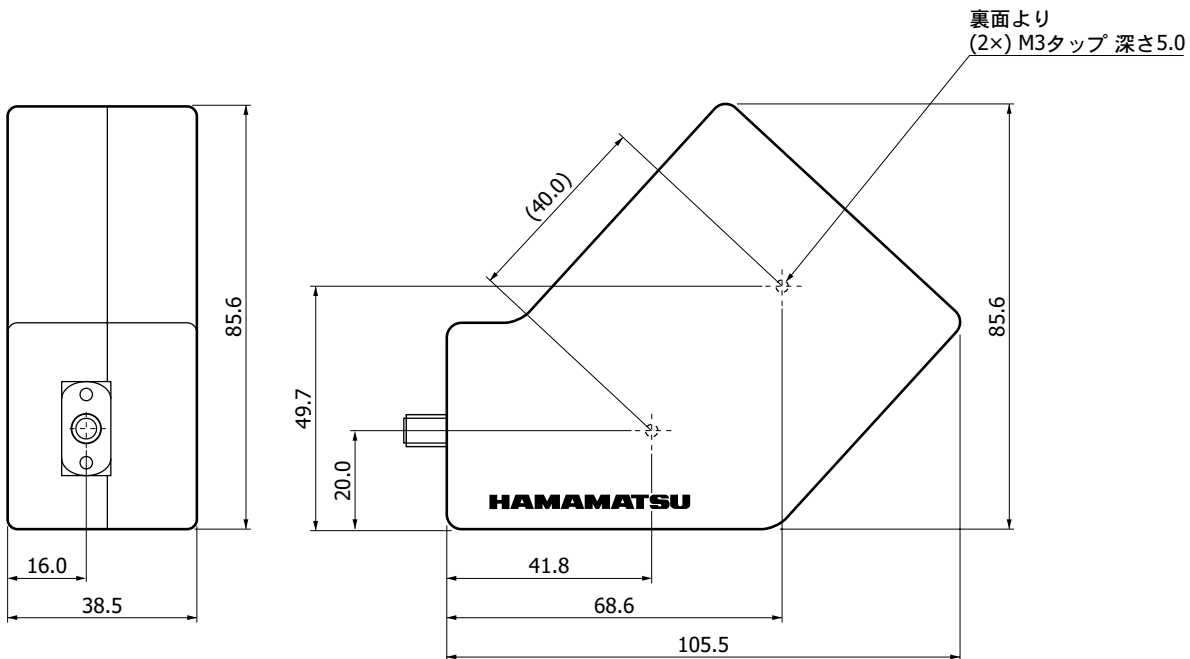

指示なき公差: ±0.5  
質量: 280 g

KACCA01463D

## ■ 付属品

- ・ USBケーブル
- ・ 専用ソフトウェア (評価用ソフトウェア、サンプルソフトウェア、DLL)


## ■ オプション (別売)

- ・ 入力用光ファイバ

型名	製品名	対応ミニ分光器	コア径 (μm)	仕様
A16963-01	可視/近赤外域用ファイバ	C11482GA (TG2-NIR)	600	NA=0.22 長さ1.5 m、両端SMA905Dコネクタ付

- ・ 外部トリガ入力用同軸ケーブル A10670

外形寸法図 (単位: mm)

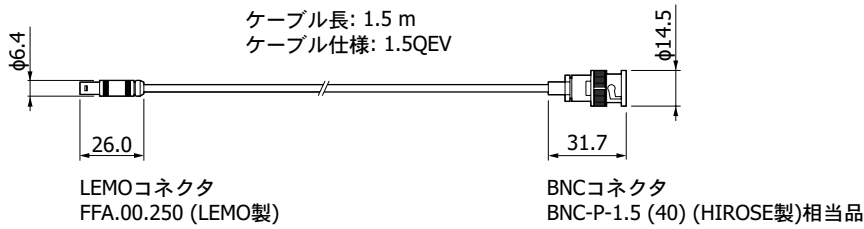

## ■ 関連情報

[http://www.hamamatsu.com/sp/ssd/doc\\_ja.html](http://www.hamamatsu.com/sp/ssd/doc_ja.html)

## ■ 注意事項

- ・ 製品に関する注意事項とお願い
- ・ ミニ分光器／使用上の注意

## ■ 技術情報

- ・ ミニ分光器／技術資料

本資料の記載内容は、令和6年3月現在のものです。

製品の仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。本資料は正確を期するため慎重に作成されたものですが、まれに誤記などによる誤りがある場合があります。本製品を使用する際には、必ず納入仕様書をご用命の上、最新の仕様をご確認ください。

本製品の保証は、納入後1年以内に瑕疵が発見され、かつ弊社に通知された場合、本製品の修理または代品の納入を限度とします。ただし、保証期間内であっても、天災および不適切な使用に起因する損害については、弊社はその責を負いません。

本資料の記載内容について、弊社の許諾なしに転載または複製することを禁じます。

## 浜松ホトニクス株式会社

[www.hamamatsu.com](http://www.hamamatsu.com)

仙台営業所	〒980-0021 仙台市青葉区中央3-2-1 (青葉通プラザ11階)	TEL (022) 267-0121 FAX (022) 267-0135
東京営業所	〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー11階)	TEL (03) 6757-4994 FAX (03) 6757-4997
中部営業所	〒430-8587 浜松市中央区砂山町325-6 (日本生命浜松駅前ビル)	TEL (053) 459-1112 FAX (053) 459-1114
大阪営業所	〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13 (大阪国際ビル10階)	TEL (06) 6271-0441 FAX (06) 6271-0450
西日本営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-13-6 (いちご博多イーストビル5階)	TEL (092) 482-0390 FAX (092) 482-0550

固体営業推進部 〒435-8558 浜松市中央区市野町1126-1 TEL (053) 434-3311 FAX (053) 434-5184